

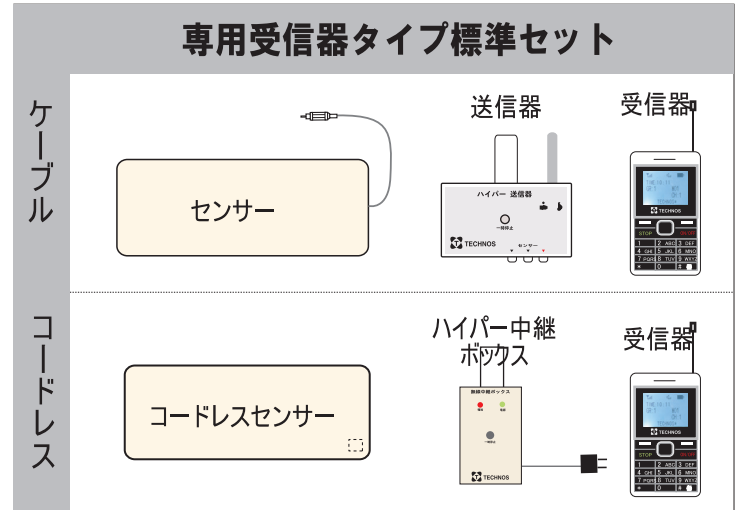


# 専用受信器タイプ⇄ナースコール連動タイプの切替え

タイプを切り替える際は、ご使用中の製品構成と必要部材をご確認下さい。

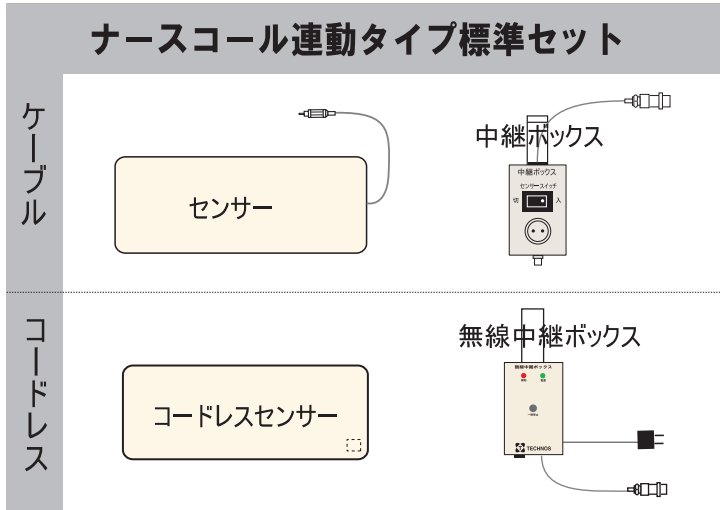

## ナースコール連動→専用受信器タイプ

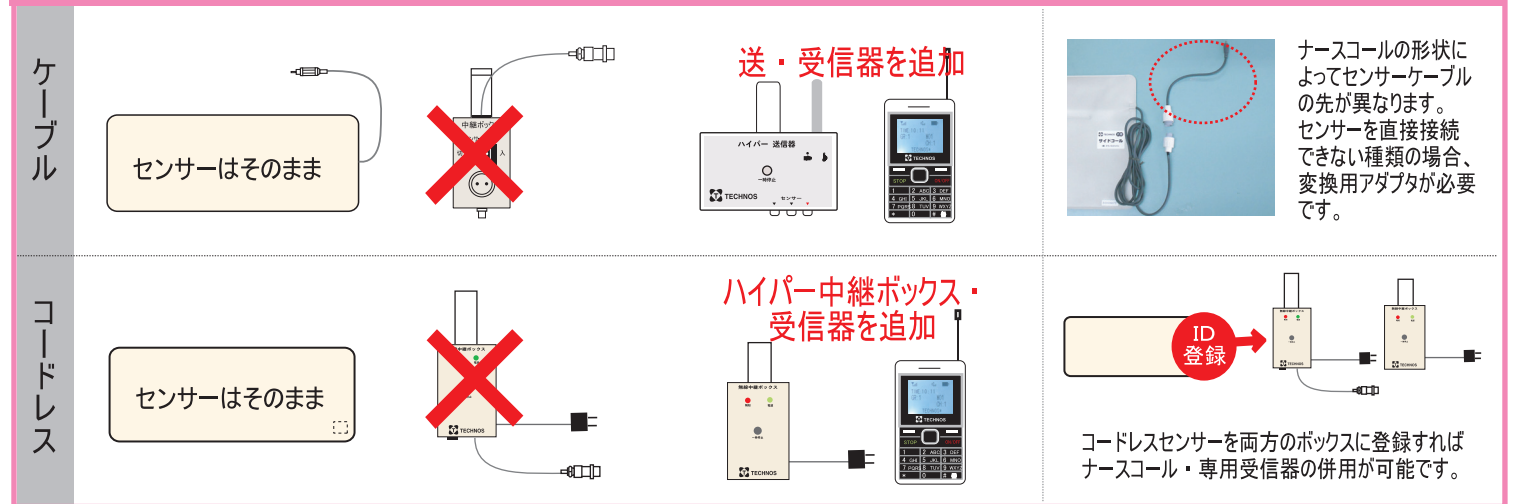

## 専用受信器タイプ→ナースコール連動タイプ

