


ナースコール連動タイプ ケアコム社 well シリーズ 離床センサーと分配コンセントの接続方法

■ コードレスタイプ

標準2P無線中継ボックスを分配コンセントに接続




無線

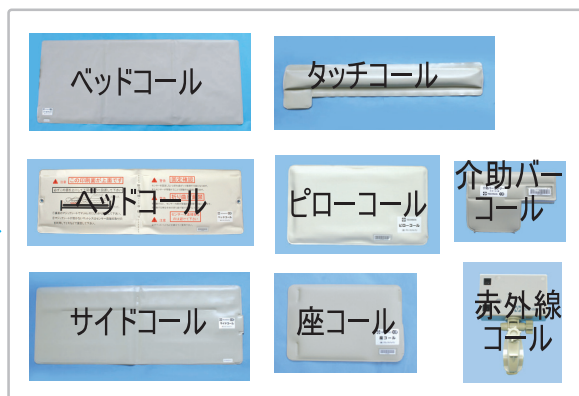

■ ケーブルタイプ

① 標準2P中継ボックスを分配コンセントに接続

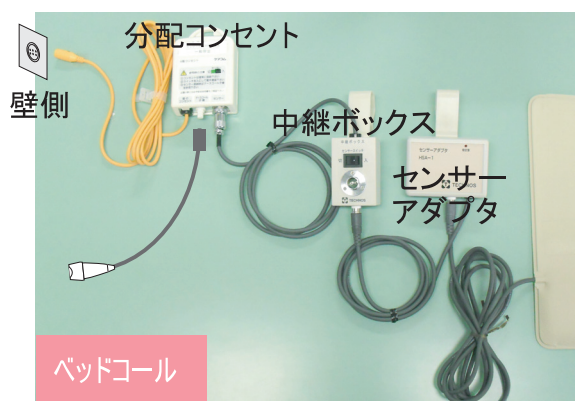

② 標準2Pプラグ付センサーを分配コンセントに接続

